



Préparation de la solution d'injection de NovoSeven® Mode de préparation avec kit de perfusion « Infusion Kit »

Le Kit de perfusion peut être commandé séparément auprès de NovoNordisk.


Procéder de manière aseptique pendant la préparation et l'administration.




Retirer la seringue de l'emballage. Ouvrir l'emballage contenant la canule de mélange. Garder la canule de mélange dans l'emballage et la fixer sur la seringue.




Tirer le piston afin d'aspirer dans la seringue une quantité d'air correspondant au contenu du flacon d'eau pour injections.

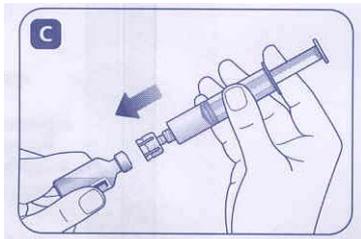


Fixer la canule de mélange sur le flacon avec l'eau stérile et injecter l'air dans le flacon, jusqu'à ce que vous sentiez une nette résistance.

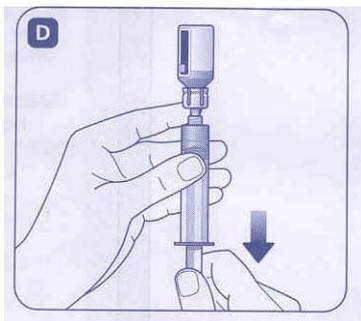


Tenir la seringue avec le flacon (eau pour injections) à l'envers et tirer le piston afin d'aspirer l'eau dans la seringue.

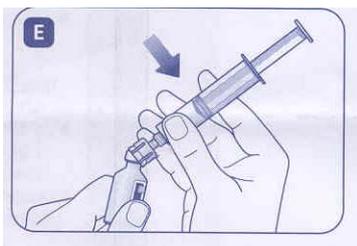


Retirer le flacon vide par un mouvement d'aller-retour de la seringue (qui doit rester fixée à la canule de mélange).

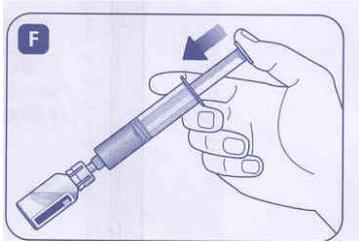


Fixer la canule de mélange (encore attachée à la seringue) au flacon contenant la poudre. Tenir la seringue légèrement penchée, le flacon dirigé vers le bas. Presser lentement le piston afin d'injecter l'eau dans le flacon contenant le lyophilisat. Attention : ne pas diriger le jet du liquide directement sur la poudre afin d'éviter la formation de mousse.

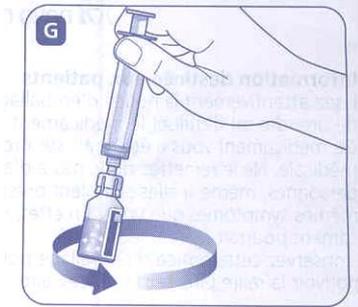

Tourner délicatement le flacon jusqu'à la dissolution de la poudre. Attention : le flacon ne doit pas être agité car cela provoquerait la formation de mousse.

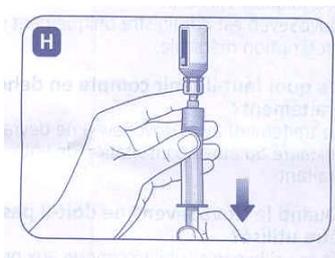

Vérifier que le piston est complètement enfoncé avant de tourner la seringue à l'envers (le piston pourrait avoir été repoussé par la pression à l'intérieur de la seringue). Tenir la seringue (attachée au flacon) à l'envers et tirer le piston afin d'aspirer la totalité de la solution dans la seringue.

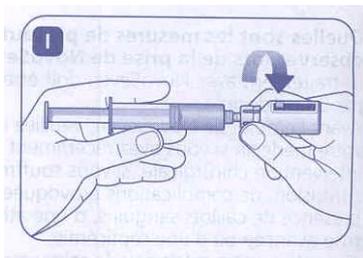

Dévisser la canule de mélange du flacon vide.

Administration de la solution de NovoSeven®

La solution prête à l'emploi doit être utilisée immédiatement après la préparation (le NovoSeven® reconstitué ne doit pas être conservé dans la seringue en plastique).

Le NovoSeven® ne doit être injecté que sous forme d'une injection en bolus par voie intraveineuse et ne doit pas être mélangé à d'autres solutés de perfusion ni être donné par un système de pompe. La vitesse de la perfusion doit être de **2 ml/mn.**