

PROCEDURE : DMx CONCERNES PAR LA MCJ

Rédigé : H.Ney/13.02.2012

Vérifié : C. Brehier/13.02.2012

Approuvé : H. Ney/13.02.2012


Concerne : L'ensemble des HUG

Quels DMx sont concernés par le traitement spécifique MCJ?


Tous les DMx utilisés sur un patient présentant un ou plusieurs symptômes faisant suspecter la MCJ après anamnèse médicale.

Suivre les arbres décisionnels ci-dessous.

(Tableau 1)

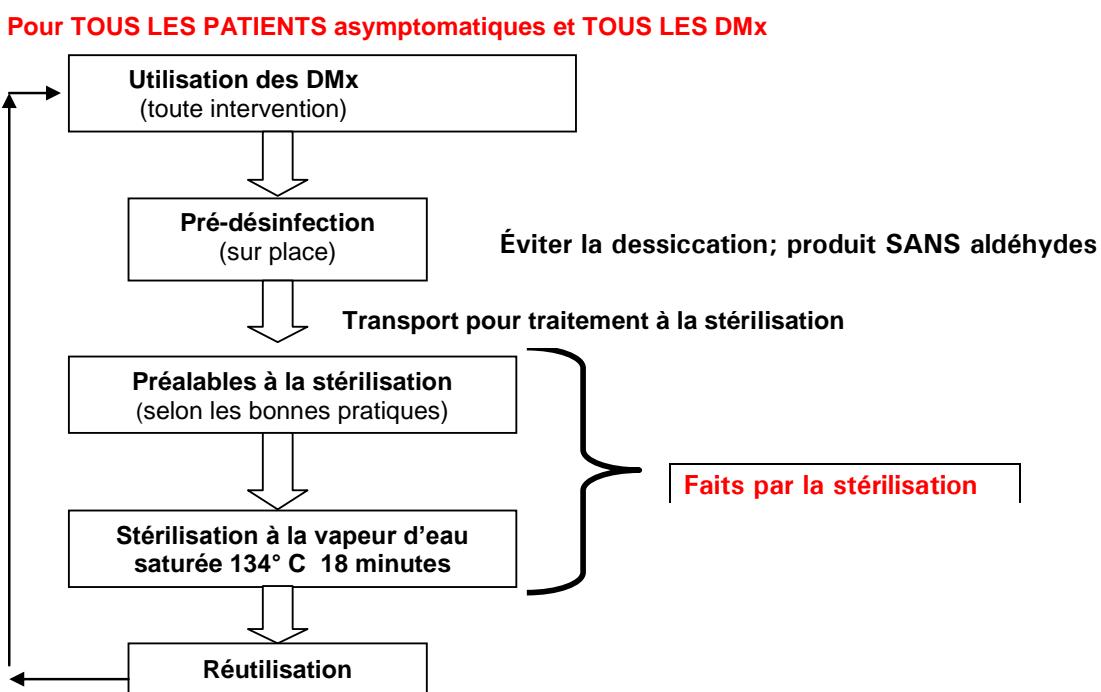

Pour les patients « liste MCJ alerte » (faire anamnèse pour la MCJ par un médecin)

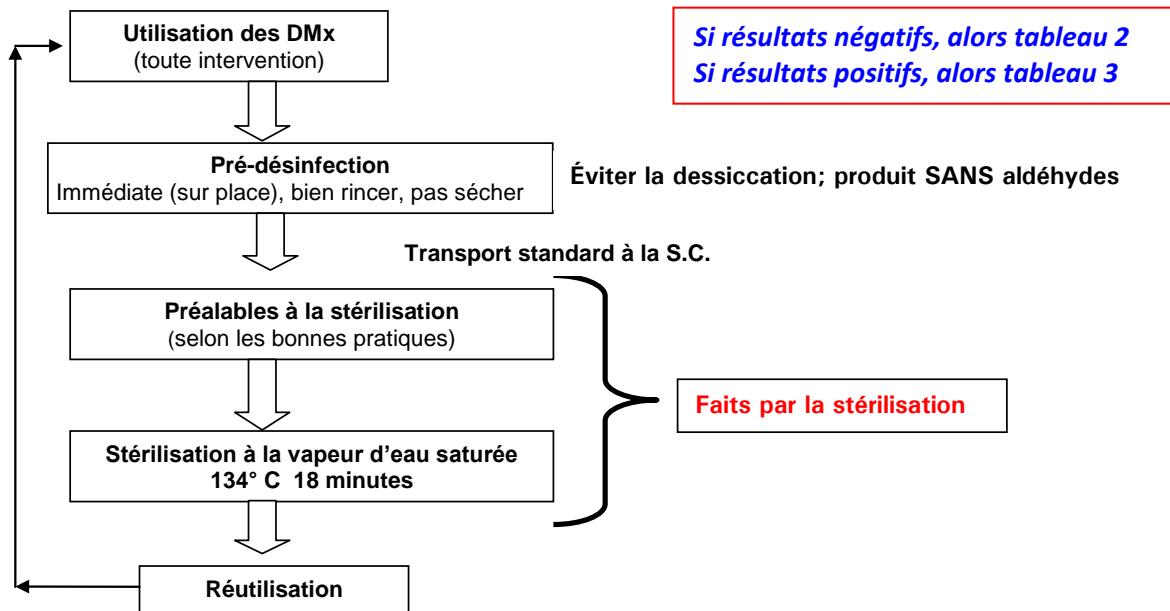

(Tableau 3)

Patient suspect de MCJ (DEMANDER PLUSIEURS ETIQUETTE PATIENT POUR IDENTIFICATION DU MATERIEL)

Les DMx doivent dans la mesure du possible être **à usage unique**^(*)

(*) A jeter dans la filière jaune et les métalliques dans le sharpsafe®. Ces 2 filières sont incinérées à température > 800° C.

